



## Руководство пользователя Комплекта для калибровки

### НАЧАЛО РАБОТЫ

---

#### Краткая информация о Комплекте для калибровки

Комплект для калибровки Био-Велл включает в себя устройства, которые позволят Вам провести калибровку вашего прибора Био-Велл и выполнить анализ окружающей среды. Для осуществления анализа окружающей среды Вам необходим прибор Био-Велл и активная подписка на пользование программным обеспечением Био-Велл. Более подробную информацию о подписке Вы можете получить на сайте [www.Bio-Well.com](http://www.Bio-Well.com)

Комплект для калибровки Био-Велл содержит:

- соединительный кабель;
- вставку с металлическим цилиндром;
- пластиковую подставку.

#### Калибровка Био-Велл

---

Инструкции по калибровке: [www.bio-well.eu/forum/viewtopic.php?f=16&t=10](http://www.bio-well.eu/forum/viewtopic.php?f=16&t=10)

Для калибровки Вам потребуется Калибровочный комплект, содержащий калибровочную подставку, вставку с металлическим цилиндром, соединительный кабель.

Для получения надёжных воспроизводимых данных, как для проведения тестирования человека, так и для съёмок с электродом Спутник, необходимо проводить калибровку в следующих случаях:

1. При переезде из одной климатической зоны в другую.
2. При полной луне, новой луне.
3. При существенном изменении погодных условий.
4. При смене сезонов года.
5. Параметры прибора чувствительны к влажности воздуха, поэтому при её существенном изменении необходимо провести калибровку.

Процедура калибровки для съёмки пальцев:

1. Выньте Вставку для пальца и поместите прибор на калибровочную подставку (рис.1)

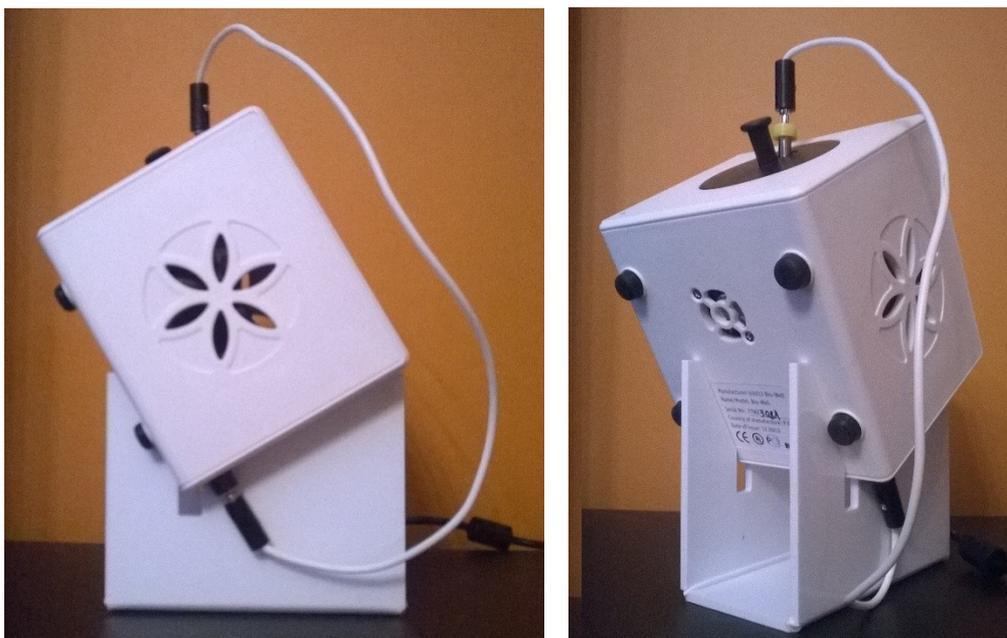


Рис.1. Био-Велл на калибровочной подставке.

2. Протрите оптическую линзу тканью (лучше с использованием спирта).
3. Установите вставку с металлическим цилиндром и соедините проводом с гнездом заземления прибора.
4. Подключите Био-Велл к компьютеру.

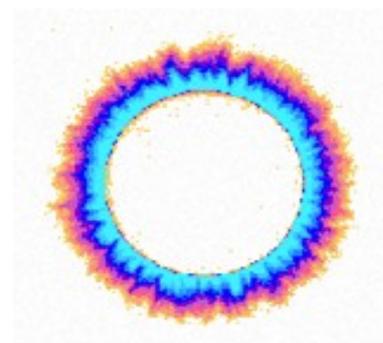


Рис. 2.

5. Протестируйте изображение в режиме Полный Анализ – оно должно выглядеть как кружок без внутренней засветки (рис.2). В случае засветки – выньте вставку с цилиндром и установите её аккуратно заново. Повторяйте данную процедуру до получения четкого изображения.
6. Откройте режим Калибровка и нажмите Старт. Программа выполнит калибровку и произведет настройку прибора (это может занять до 5-6 минут).
7. По окончании процесса выньте вставку с металлическим цилиндром.
8. Вы можете использовать ваш Био-Велл.

Успешных экспериментов!